



Universidade de São Paulo
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto
Disciplina de Oclusão

DISPOSITIVOS INTEROCCLUSAIS

Prof. Dr. César Bataglion
Oclusão/DTM e DOF – FORP-USP
bataglionc@forp.usp.br

Placas de cobertura total

Placas de Estabilização (miorrelaxantes)

1. De resina acrílica termopolimerizável
2. De acetato recoberto com resina acrílica autopolimerizável

Placas de cobertura parcial anterior

1. Front-plateau

Overlays

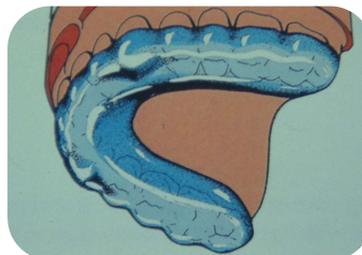


Imagem: Bataglion, C. Arquivo pessoal

Placas oclusais são dispositivos intrabuciais, removíveis, confeccionados geralmente em resina acrílica, recobrimdo as superfícies oclusais e incisais dos dentes.
(Fernandes Neto & Barbosa, 2006).

Placas de cobertura total - estabilizadoras -



Imagem: Bataglion, C. Arquivo pessoal

Resina acrílica termopolimerizável

Placa estabilizadora





**Ajuste oclusal da placa
em RC**



Imagens: Bataglion, C. Arquivo pessoal

**Placa de acetato com cobertura de resina
acrílica de rápida polimerização
(autopolimerizável)**

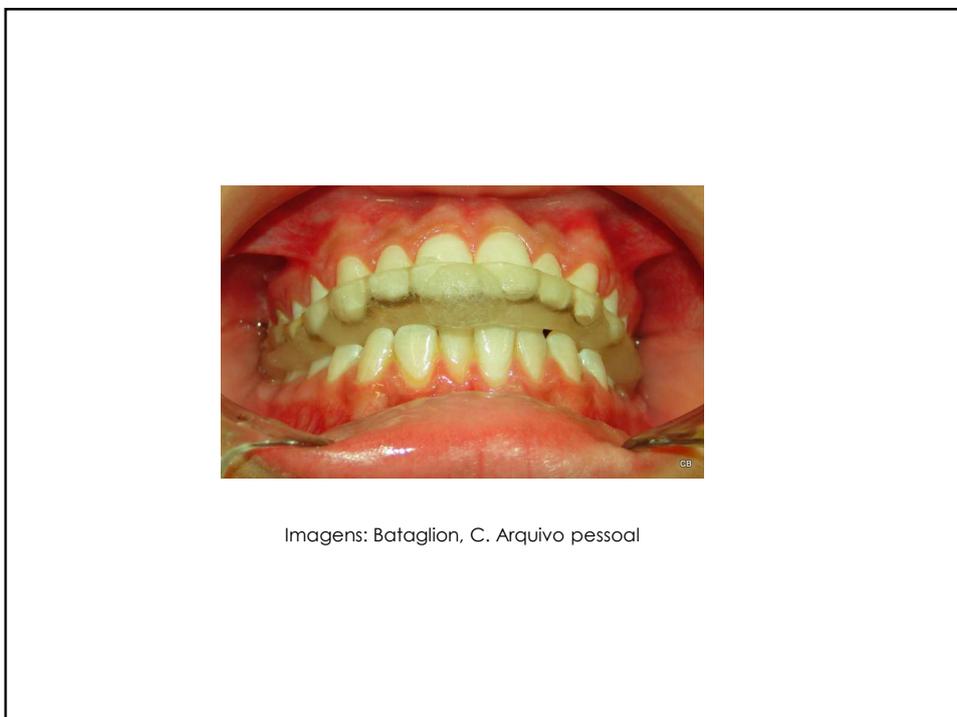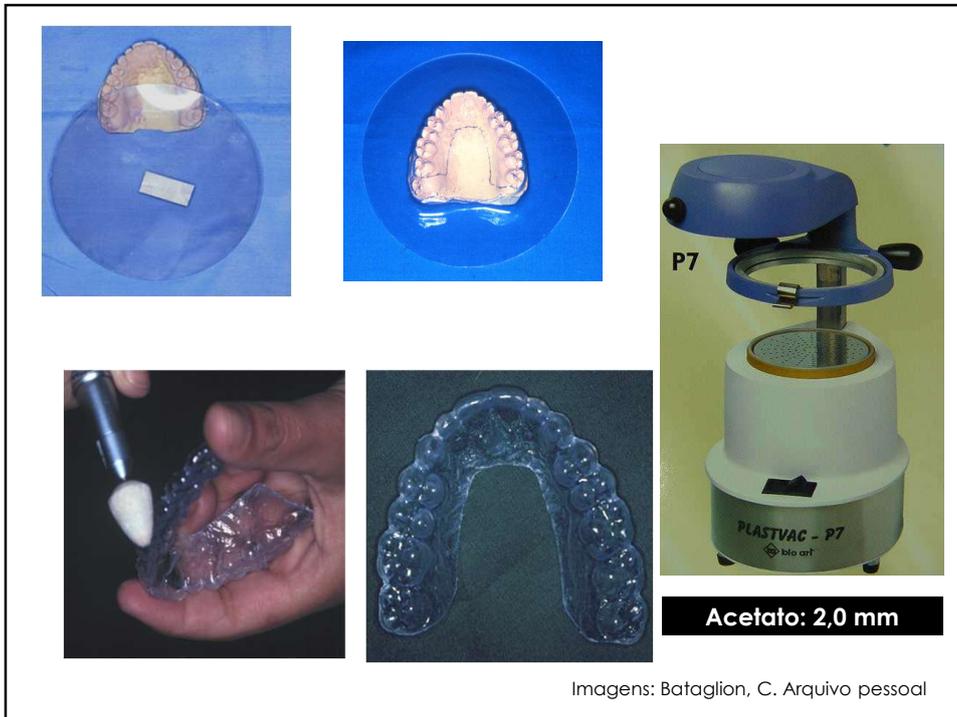

Placas de cobertura parcial anterior

Front-plateau




Bataglion, C. Arquivo pessoal

Placa de cobertura parcial ANTERIOR "Front-plateau"

Placa de mordida anterior

Aparelhos de cobertura parcial anterior, **utilizados para desocclusão dos dentes posteriores.** (Fernandes Neto, 2013; Okeson, 2013,).

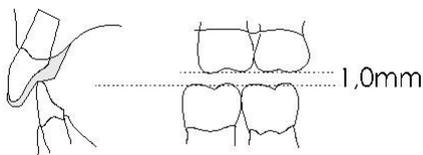


Bataglion, C. Arquivo pessoal

Placa de cobertura parcial ANTERIOR "Front-plateau"

Indicação:

- ✓ Casos agudos de DTM: cocontração protetora.
- ✓ Dificuldade de manipulação da mandíbula.
- ✓ Instabilidade mandibular

Okeson, 2013

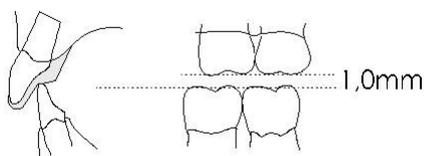

Bataglioni, C. Arquivo pessoal

Placas de cobertura parcial ANTERIOR

Vantagens: facilidade de fabricação e procedimentos de ajuste e adaptação

Desvantagens: movimento dental descontrolado (Ramfjord & Ash, 1983; Clark, 1989; Nelson, 1995), podendo promover extrusão, gerando uma mordida aberta anterior (Okeson, 1992). USO POR 24 a 72 HORAS.



Bataglioni, C. Arquivo pessoal

Overlay

✓ Aparelho protético removível confeccionado em resina acrílica (ou estrutura metálica) sobre uma ou ambas as arcadas, que apresentam falhas dentárias ou dentes com excessivo desgaste incisal/oclusal.

Fernandes Neto, Oclusão, Série Abeno, 2013.

1. Overlay de estrutura metálica



Imagens: Bataglion, C. Arquivo pessoal

Overlay

2. Overlay

✓ Indicada para pacientes com alteração da dimensão vertical de oclusão (DVO) , que geralmente se encontra "diminuída"

✓ Funciona como um importante meio auxiliar no diagnóstico e prognóstico de tratamentos que envolvem o restabelecimento da DVO, possibilitando uma análise prévia das respostas do sistema neuromuscular antes que o tratamento proposto seja iniciado



Bataglion, C. Arquivo pessoal



Bataglion, C. Arquivo pessoal

Overlay

2. Overlay de resina acrílica termopolimerizável



Bataglion, C. Arquivo pessoal



Bataglion, C. Arquivo pessoal

